


■ 簡介：

橡膠試驗片適用於硬度計之精確度的確認。

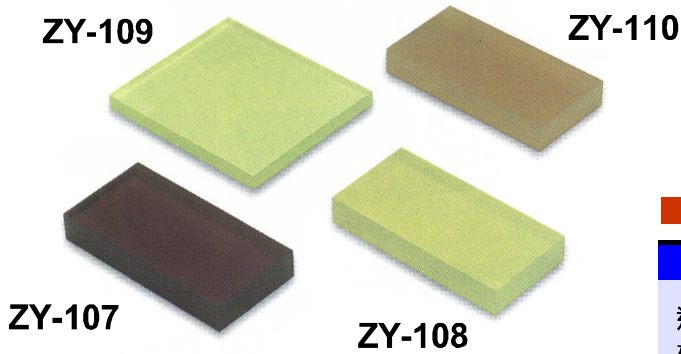

■ 規格：

型號	適用基準值	外觀尺寸(mm)
ZY-107	A 50	40×80×12 (厚)
ZY-108	A 80	40×80×12 (厚)
ZY-109	D 40	70×80×7 (厚)
ZY-110	E 80	40×80×12 (厚)

■ 適用於 JIS K 6253 規範之各種硬度計：

型號	ZY-107	ZY-108	ZY-109	ZY-110
適用之 硬度計	GS -719N	GS -719N	GS -720N	GS -721N
	GS -719G	GS -719G	GS -720G	GS -721G
	GSD-719	GSD-719	GSD-720	GSD-721

■ 橡膠硬度比較參考表（下列表格以 A-Type 之測定硬度值為基準）：

下列圖表無法精確的證明每一種型式橡膠硬度計之測試值的連帶關係。原因在於不同廠商生產的過程中，橡、塑膠硫化的條件互異，而量測時，操作環境的溫度、濕度及形狀等的變動因素，都將影響其測試結果。因此，僅提供予使用者參考各種形式之硬度計其間的相對關係。

A-type JIS K 6253, JIS K 7215	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100				
(old A-type) JIS K 6301		10	20	30	40	50	60	70	80	90					
E-type JIS K 6253			20	30	40	50	60	70	80	90					
SRIS-type SRIS 0101			20	30	40	50	60	70	80	90					
E2-type TECLOCK E2			30	40	50	60	70	80	90						
D-type JIS K 6253, JIS K 7215						10		20		30	40	50			
DO-type ASTM D 2240				10		20		30		40	50	60	70	80	90
O-type ASTM D 2240					20	30	40	50	60	70	80				
OO-type ASTM D 2240							50	60	70	80	90				
B-type ASTM D 2240					10		20		30	40	50	60	70	80	90
C-type ASTM D 2240						10		20		30	40	50	60	70	80